


AUSGABE 50 | November 2025

Anpassung von weichen Contactlinsen bei Presbyopie

Im August 2025 wurde unser Tauschlinsen-Sortiment mit der FIT SH multifokal ergänzt. Wir nutzen diese Gelegenheit und thematisieren das Therma Presbyopieversorgung in 3 aufeinanderfolgenden **updates**. In dieser ersten Ausgabe zeigen wir auf, wie Sie mit Struktur und einer genauen Bedarfsanalyse eine Anpassung erfolgreich beginnen.

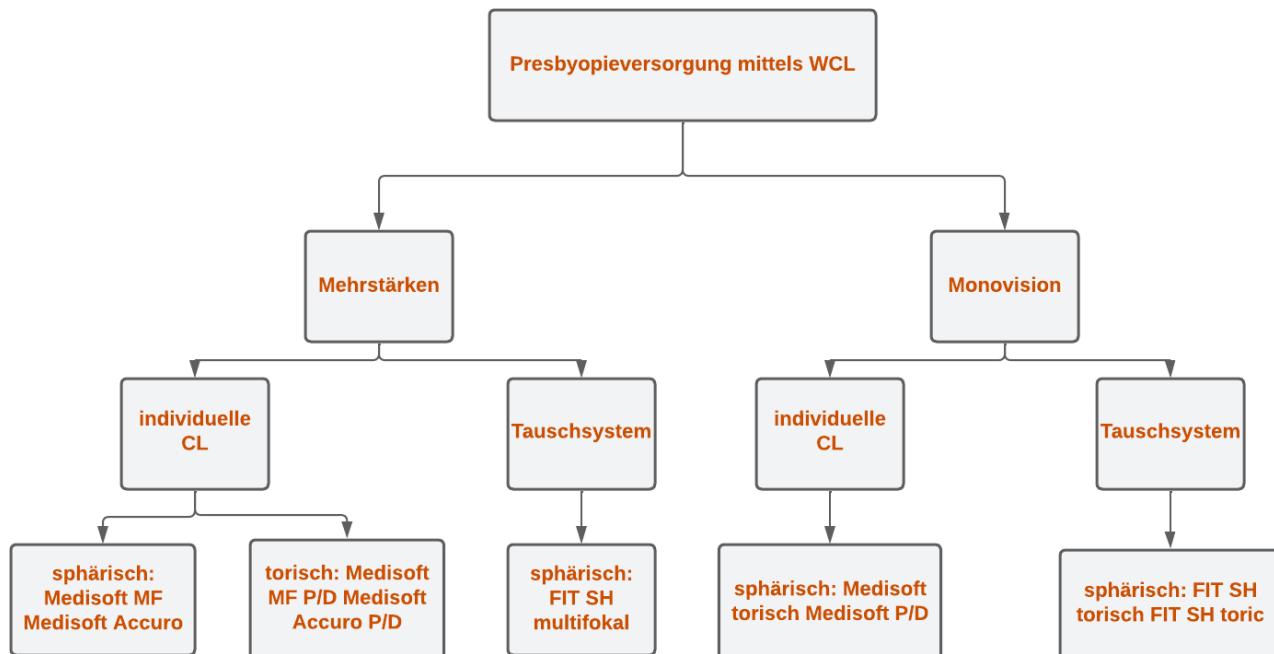

Mit Systematik zum Erfolg

Ein grundlegendes Verständnis der Produktspezifikationen ist die Basis für eine erfolgreiche und wirtschaftlich lukrative Versorgung. Wir zeigen Ihnen in den kommenden beiden **updates** die Charakteristika jeder Versorgungslösung auf.

Zu Beginn ist die Kommunikation mit der Kundschaft entscheidend – sowohl in der Zieldefinition wie auch bezüglich der Möglichkeiten der geplanten Anpassung. Sie werden erfolgreich sein, wenn Sie die Wünsche und Anwendungsbereiche Ihrer Kundschaft kennen. Konzentrieren Sie sich auf diese Punkte und wählen aufgrund dieser Priorisierung das erfolgsversprechende System aus. Wir verweisen bezüglich Kommunikationstipps auf die **update**-Ausgabe 14. Mit unserm Leitfaden präsentieren wir Ihnen einen übersichtlichen

Entscheidungsraster über die gängigsten Versorgungsoptionen.

TIPP:

Bleiben Sie dennoch flexibel und überdenken Sie bei verändernden Ansprüchen während der Anpassungsphase das gewählte Vorgehen.

Wollen Sie sich weiter auf diesem Feld profilieren? Gerne unterstützen wir Sie mit weiteren Informationen oder einer persönlichen Weiterbildung.